


УДАЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ГРИБКОВ И БАКТЕРИЙ

Размерная шкала (1 мм = 1000 мкм)


ФИЛЬТРАЦИЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ

Sterifilt FAST
Sterifilt BASIC

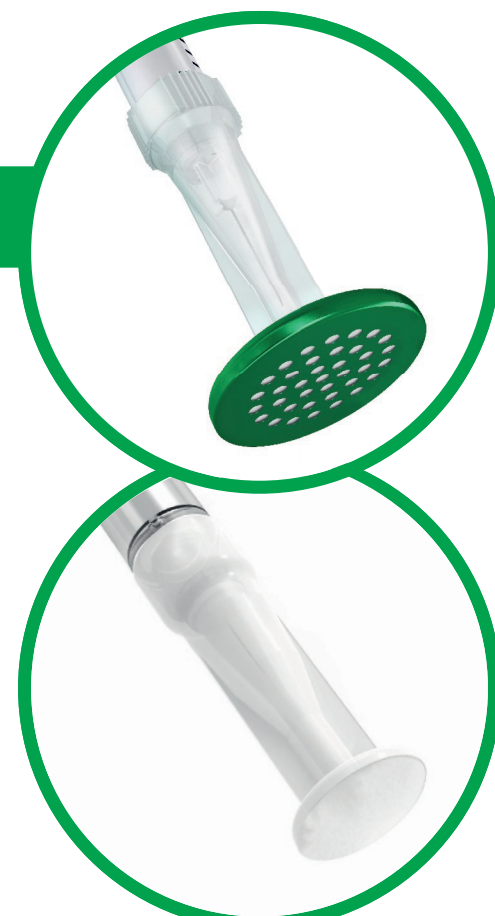


Нерастворимые частицы
15 мкм

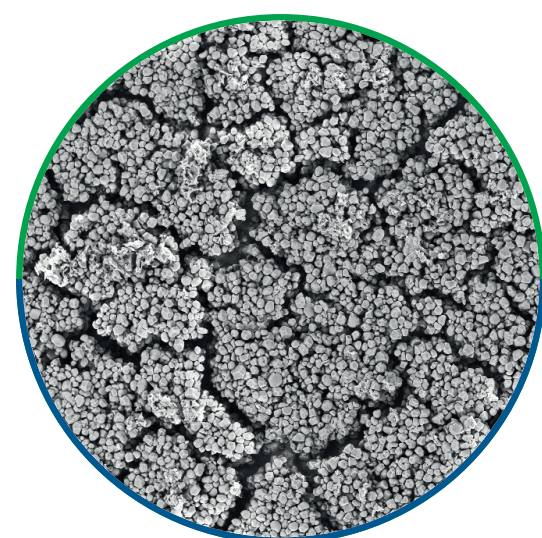


10 µm

Грибы (дрожжи)
10 мкм

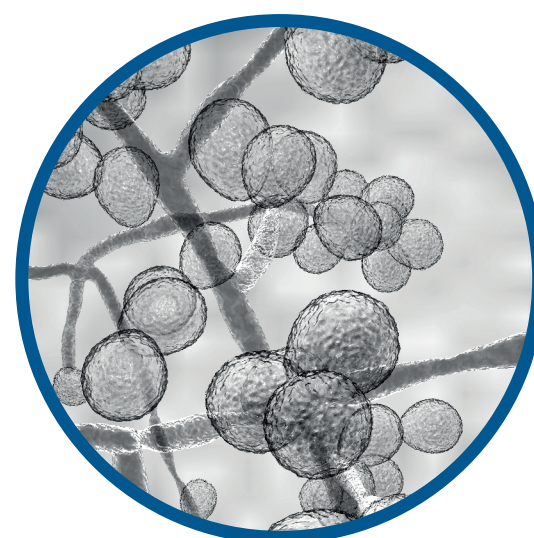

Бактерии
от 0,5 до 10 мкм

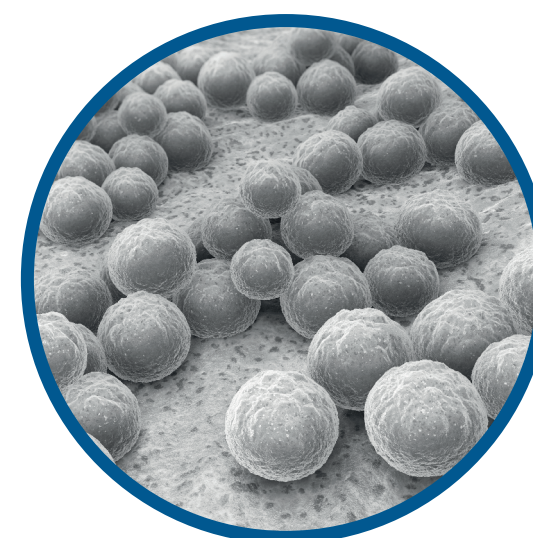


Sterifilt®
Фильтр «волчок»




0,2 µm

НЕФИЛЬТРОВАННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Вирус (ВИЧ, ВГС)
от 0,05 до 0,15 мкм

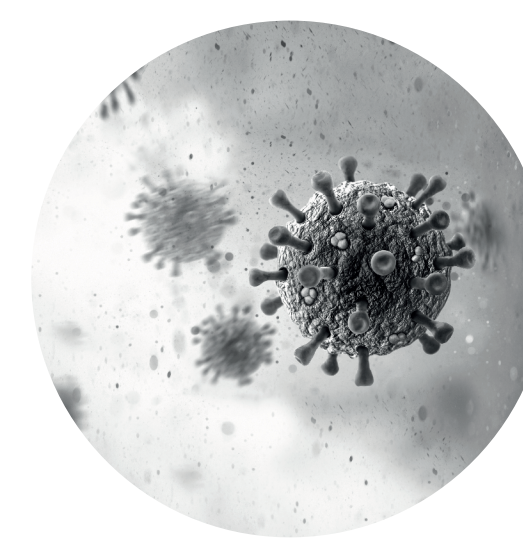

Молекулы (кокаин, морфин ...)
от 0,001 до 0,01 мкм

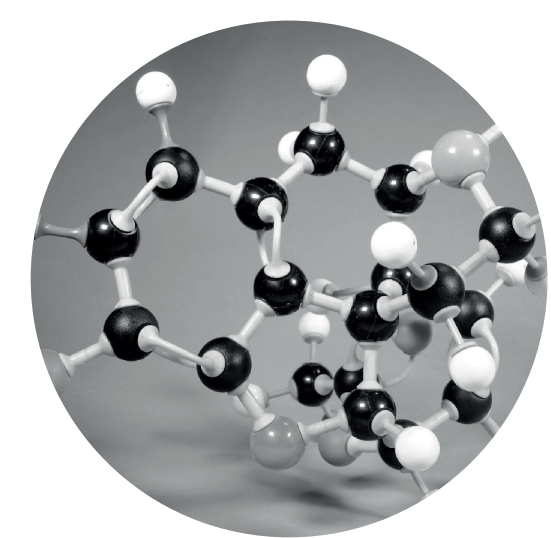

Во избежание
заражения вирусами
не делитесь ни
с кем своими
принадлежностями

Фильтрация
не устраняет
активное вещество

СНИЗИТЬ РИСКИ

- Использовать стерильное оборудование
- Мойте руки с мылом или протирайте их гелем с гидроспиртом
- Прозеинфицируйте место инъекции спиртовым тампоном (70%)
- Никогда не облизывайте иглу


Apothicom
apothicom.org