

ÉLIMINATION DES PARTICULES, CHAMPIGNONS ET BACTÉRIES

Échelle de taille (1 mm = 1000 µm)


FILTRATION

FILTRATION

Sterifilt FAST
Sterifilt BASIC




Particules insolubles
15 µm

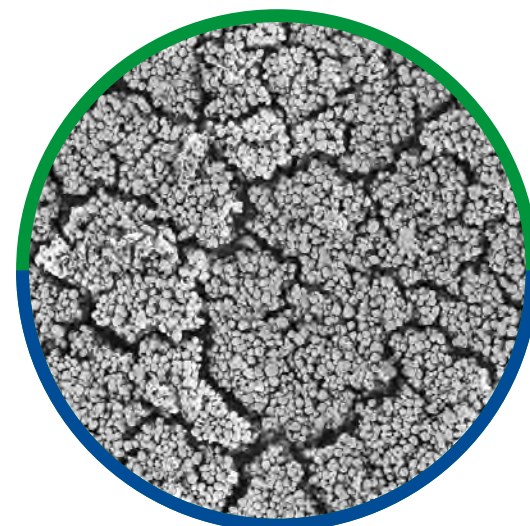

10 µm


Champignons (levures)
10 µm

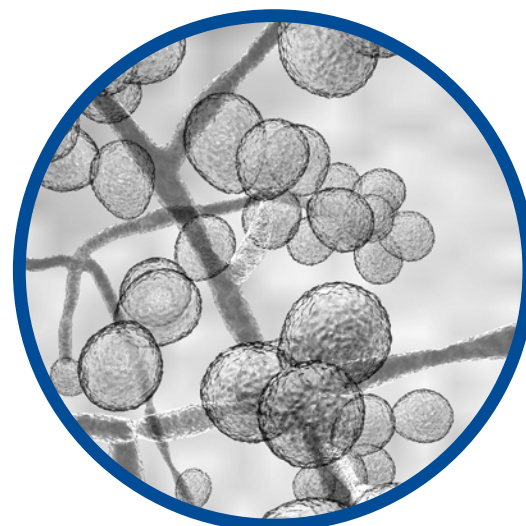

Sterifilt⁺
Filtre "toupie"




Bactéries
1 à 10 µm

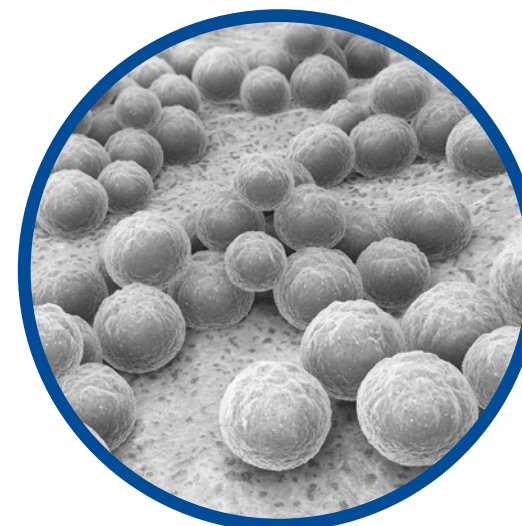


0,2 µm

Virus (VIH, VHC)
0,05 à 0,15 µm

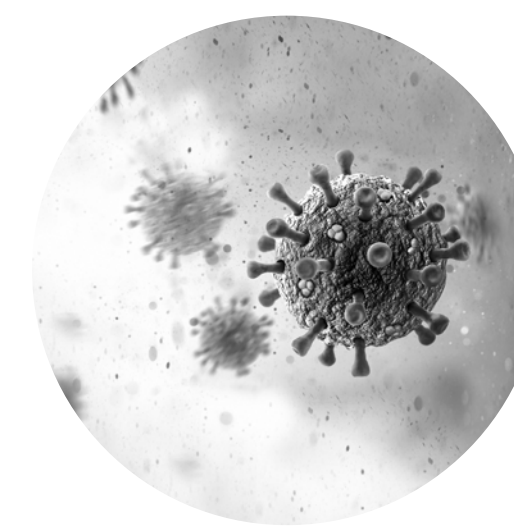

ÉLÉMENTS
NON FILTRÉS

Molécules (cocaïne, morphine, ...)
0,001 à 0,01 µm

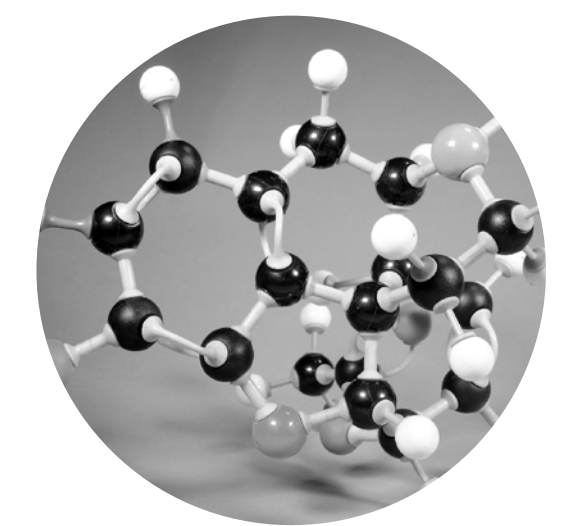

Pour éviter les virus,
ne partagez pas
votre matériel.

Filtrer n'élimine pas
votre produit actif !

RÉDUISEZ LES RISQUES !

- Utilisez du matériel stérile
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou frictionnez-les avec du gel hydroalcoolique
- Désinfectez le site d'injection avec un tampon alcool (70%)
- Ne léchez jamais l'aiguille