


FILTRERING AV PARTIKLAR, BAKTERIER OCH SVAMP

Skala (1 mm = 1000 µm)


FILTRERING

FILTRERING

Sterifilt FAST
Sterifilt BASIC

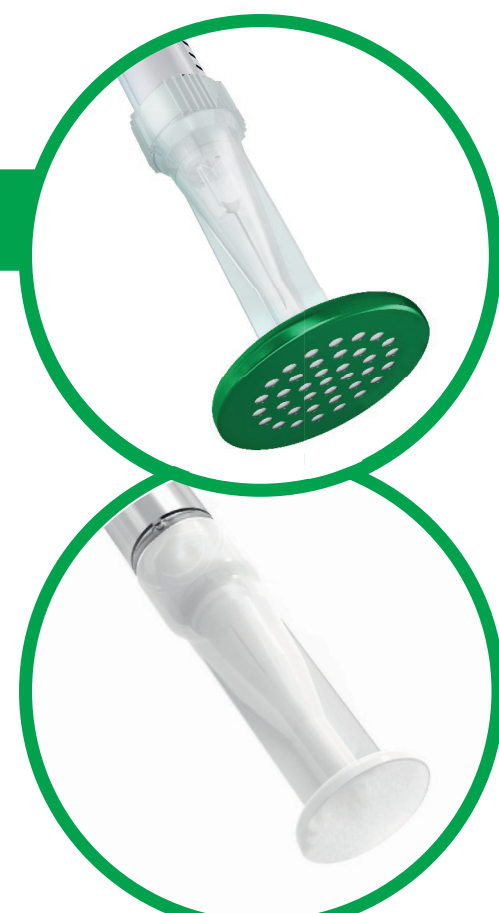


Olösliga partiklar
15 µm

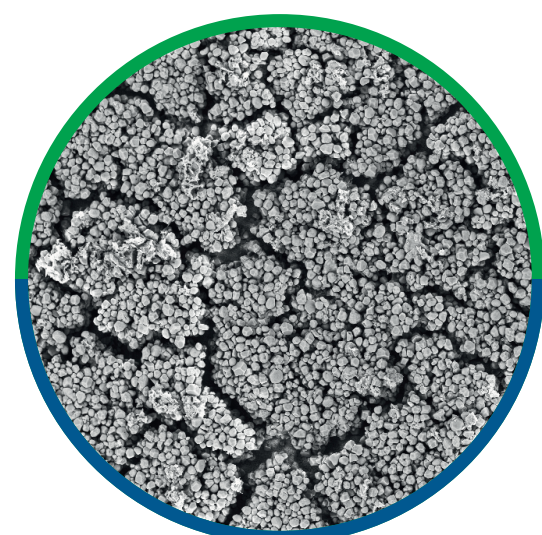

10 µm


Svamp (jäst)
10 µm

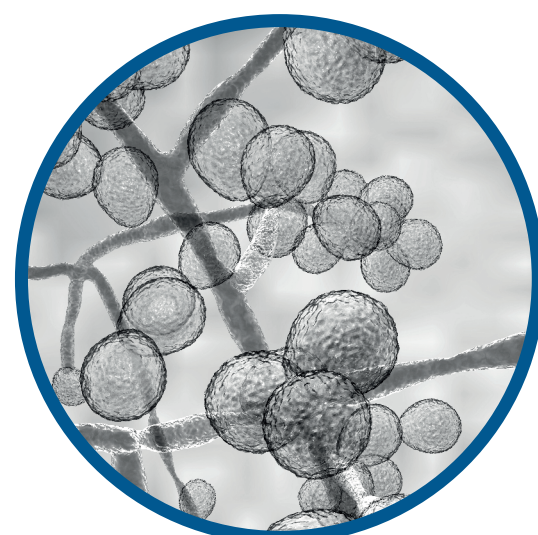

Sterifilt⁺
Hjulfilter




Bakterier
0,5 till 10 µm

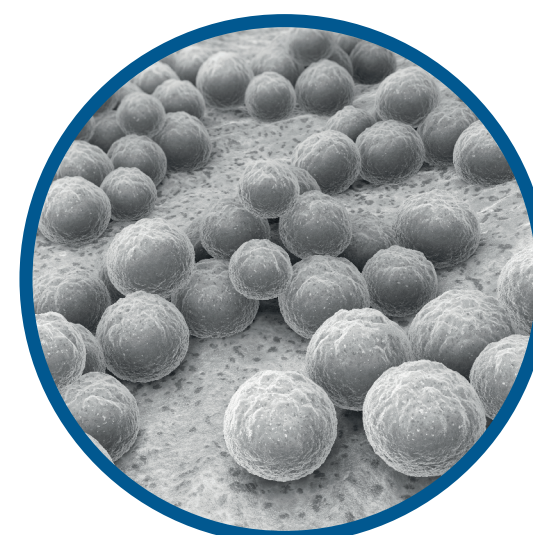

0,2 µm


ICKE BORTFILTRERADE
ELEMENT

Virus (HIV, HCV)
0,05 till 0,15 µm

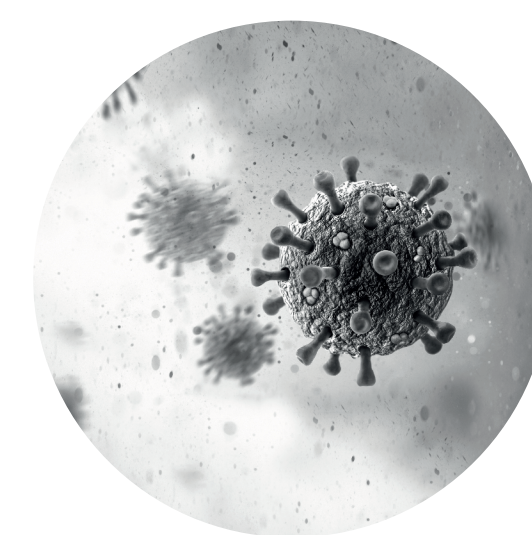

Dela inte verktyg,
för att undvika virus.

Molekyler (kokain morfin..)
0,001 till 0,01 µm

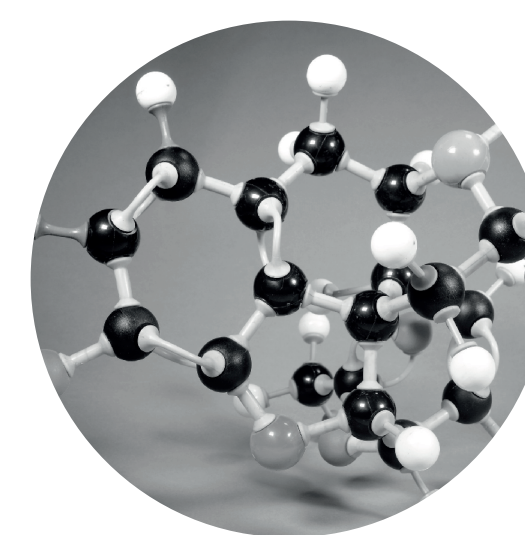

Filtret tar inte bort de
aktiva substanserna.

MINSKA RISKERNA!

- Använd sterila verktyg och engångsmaterial
- Tvätta händerna med tvål och vatten eller med en alkoholbaserad lösning
- Desinficera injektionsstället med en alkoholindränkt bomullspad (70%)
- Slicka inte på nålen